

Návod na obsluhu

QM Therapy

3.1.



Obsah

Obsah	2
1 Úvod	3
Nastavení PC	3
1.1 Další programy QM Scan a FGT Gener	3
2 Funkce	4
3 Spuštění programu	5
4 Vegetotest	8
5 Přednastavení	9
6 QM Scan	15
7 QM Therapy	18
8 Přehled	19
9 Rozšířené	21
10 Výstupy	22
11 Časování QM Therapie (není u všech variant)	23
12 QM Scan	26
13 Vitarego (rozšíření QM Therapy)	27
Nastavení Vitarego	28
14 Podklady	31

1 Úvod

Děkujeme, že jste rozhodli využívat software QM Therapy Qmtrin®

QM Therapy Qmtrin® je aplikace s externí jednotkou pro sběr dat, vyhodnocení, tvorbu přehledů a tvorbu programů pro FQ Qmtrin frekvenční generátor případně pro import do jiných programů např. Ravo Rife, Elzapp apod.

Nejedná se o lékařský přístroj a neslouží k léčení ani diagnostice.

QM Therapy je nutno skladovat i provozovat v čistém a suchém prostředí, při pokojové teplotě, nezakrývat. Pokud bude vystaven nízkým teplotám, je třeba nechat QM Therapy pozvolna ohřát na pokojovou teplotu. QM Therapy je nutno provozovat pouze pod dozorem a při ukončení provozu je nutno odpojit od PC.

Nastavení PC

Nastavení PC pro správné zobrazení software na PC, je nutno PC správně nastavit:


1) Nastavení / usnadnění přístupu / obrazovka / měřítko a rozložení = 100 %

2) Nastavení / usnadnění přístupu / obrazovka / rozlišení nejlépe cca 1600x900. Jedná se o přibližné hodnoty.

1.1 Další programy



QM Scan –aplikace pro detekci akutních a aktuálních odezev s uvedením názvů možných patogenů. Lze provozovat i samostatně.

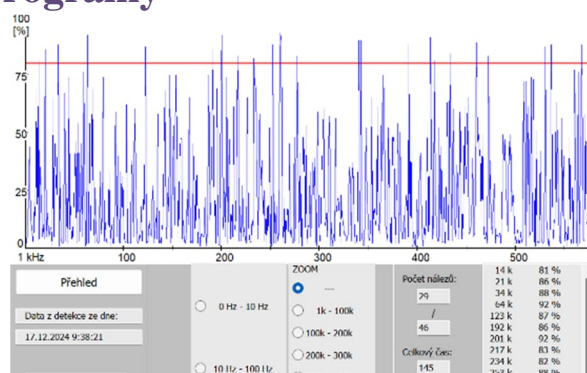

FQT Gener –aplikace pro ovládání frekvenčního generátoru. Lze provozovat i samostatně.



2 Funkce QM Therapy

QM Therapy provede detekci (někdo říká měření), analýzu a proceduru (terapii). QM Scan je algoritmus pro stavení frekvenčních výstupů.

Výstupem je procedura, která se provádí ihned během analýzy. Dále jsou sestaveny konkrétní frekvence, nabídnuta doporučení existujících programů z databáze a doporučení Q-Informatik případně přípravků, doplňků a další.

Lze vytvořit program (dávku), který lze spustit přímo nebo jako soubor importovat do jiných programů.

Analýza a terapie jsou strukturální na celostním principu. Řešení vychází z vazeb jednotlivých okruhů, meridiánů a čaker.

Jejím výstupem není přehled všech existujících disharmonií (nebo frekvencí), ale pouze soubor disharmonií (nebo frekvencí), které je doporučeno řešit.

Nedílnou součástí je jejich dané pořadí a časový interval.

Uloží se soubor s protokolem pro další použití.

QM Therapy - jedná se o strukturální detekci (někdo říká měření), analýzu a proceduru, která provede vyhodnocení a doporučí úpravu kmitočtových poměrů. Z tohoto důvodu je doporučeno případné opakování **s odstupem min. 3 dnů.**

Poznámka: stěžejní činnosti a hlavním místem využití přístroje QM Therapy je frekvenční terapie (využití frekvencí v FQ Qmtrin Quantum Harmony) a QM terapie.

ZÍSKANÉ FREKVENCE JE VHODNÉ APLIKOVAT OPAKOVANĚ.

Možnost doporučení doplňků a přípravků je pouze doplňková možnost k frekvenční terapii QM (více dále v textu).

Důležité: zkušenosti, nadhled, intuici a dovednosti terapeuta nenahradí žádný přístroj. Jedná se pouze o podpůrný proces. Při řešení složitějších věcí je nutno kontaktovat terapeuta, který využije komplexnější přístup.


3 Spuštění programu

Před spuštěním počítače je nutno připojit externí jednotku do USB a nechat ji připojenou po celou dobu.

Program se spustí pomocí ikony. Při každém spuštění proběhne kontrola jeho autorizace. **Při prvním spuštění programu je nutno v nastavení zadat jeho autorizaci.** Heslo je na spodní straně USB externí jednotky.




Otevře se následující okno:

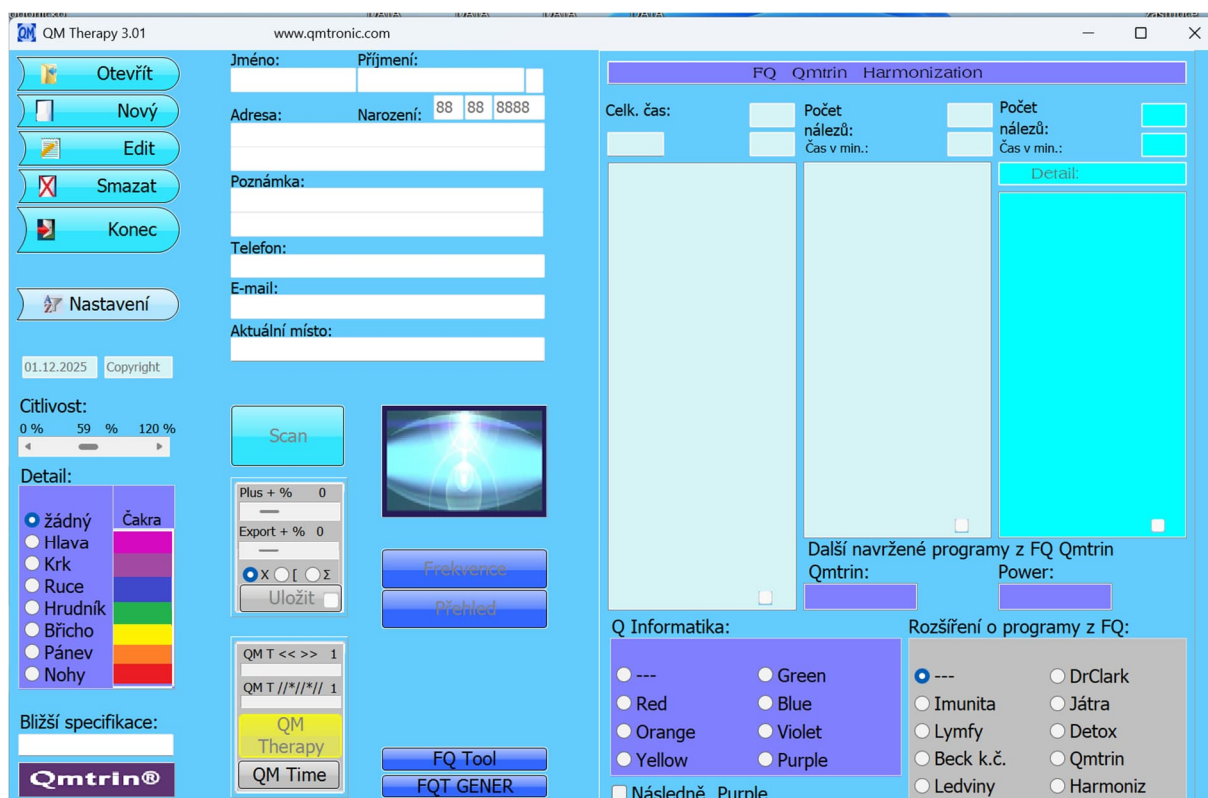




Pomocí tlačítka **Otevřít** se načtou data klienta, který byl již v minulosti uložen a pokud existují, data z detekce.




Pomocí tlačítka **Nový** se otevře okno pro vložení nového klienta, případně pro jeho editaci nebo import.




Pomocí tlačítka **Edit** otevře okno pro editaci klienta, případně pro jeho editaci nebo import.



Pomocí tlačítka **Smazat** se pomocí výběrového okna vybere klient, který se má smazat. **Nelze smazat aktuálně otevřeného klienta.**




Pomocí tlačítka **Konec** se provede ukončení programu.



Pomocí tlačítka **Nastavení** se otevře nové okno pro provedení mnoha přednastavení.

Pomocí tlačítka **Otevřít** se načtou data klienta, který byl již v minulosti zadán a uložen.

Nového klienta lze zadat v okně **Nový**, vepsáním národně do daných řádků. Tlačítkem **Edit** lze upravit existujícího klienta stávajícího klienta doplnit například telefon a email.

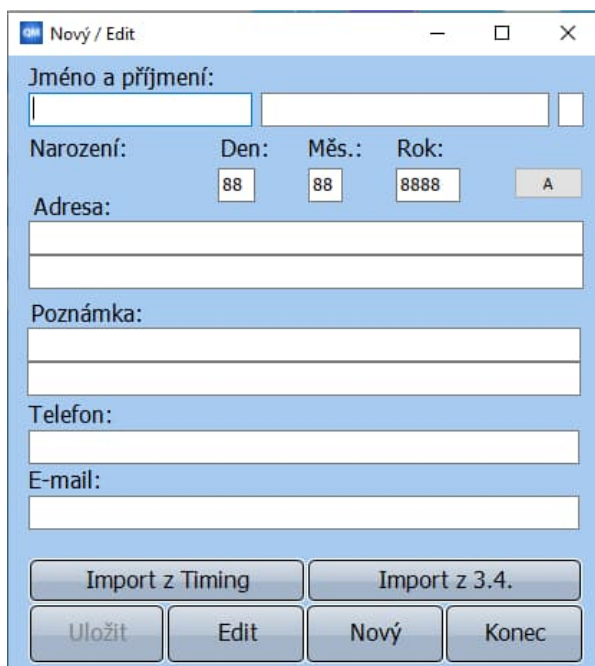


Tlačítkem **Import z 3.4** se importují národně ze starší verze.

Tlačítkem **Import z Timing** se případně importují národně ze druhého počítače, na kterém je v běhu druhá verze QM Timing.


Mezi záznamy se snadno pohybuje pomocí tabelátoru TAB.

Povinná pole jsou: *jméno, příjmení, datum narození.*

Systém využívá pro tvorbu názvu souboru s programy první písmena jména a příjmení klienta. Někdy se může stát, že např. v rodině mají dvě osoby shodná počáteční písmena.

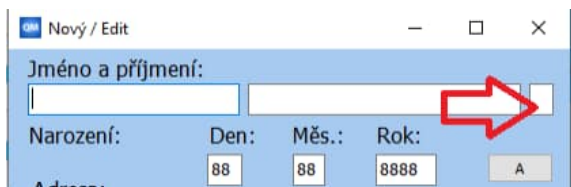

V tomto případě lze využít okénko pro vepsání jednoho písmena, které bude použito pro odlišení názvů souborů.

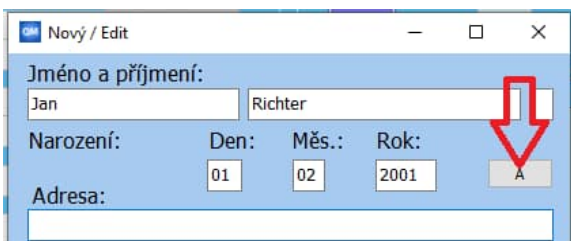

Někteří uživatelé provádí detekci zvířat. Tlačítkem se přestaví systém na zvíře.


Ukládání se provádí explicitně do složky C:\QMTherapy\ QDBZ5\ a nelze ji změnit.

V případě potřeby je možno vybrat detail, který má být analyzován. Jedná se o oblasti čaker, pro představu jsou pojmenovány: **Hlava, Krk, Ruce, Hrudník, Břicho, Pánev, Nohy**. Případně lze detail dále podrobněji specifikovat v okénku **Bližší specifikace**.

Volit detail není nutno, zpravidla jsou všechny potřebné frekvence obsaženy i v celkové sestavě (Jedná se o stav jednoho kompletního systému z celostního pohledu).




zvolí se například „Hrudník“

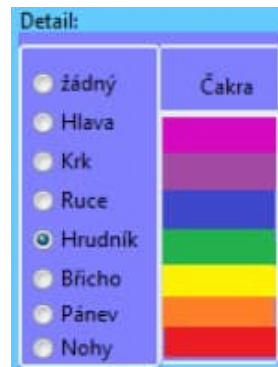

Jako poslední lze upravit citlivost v rozsahu 10 až 100%. Jedná se o jednotky, které jsou úměrné citlivosti a tím i množství řešených detekcí.


Úprava se provádí pouze tehdy, pokud je třeba u daného klienta hodnotu upravit od přednastavené.

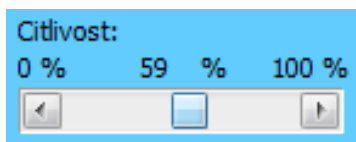

Jinak není nutno citlivost upravovat, je přednastavena v záložce nastavení.

4 Vegetotest


U některých variant lze využít vegetotest. Je nutno ho aktivovat ještě přes spuštění Scan. Tlačítkem IIIII se otevře následující okno.

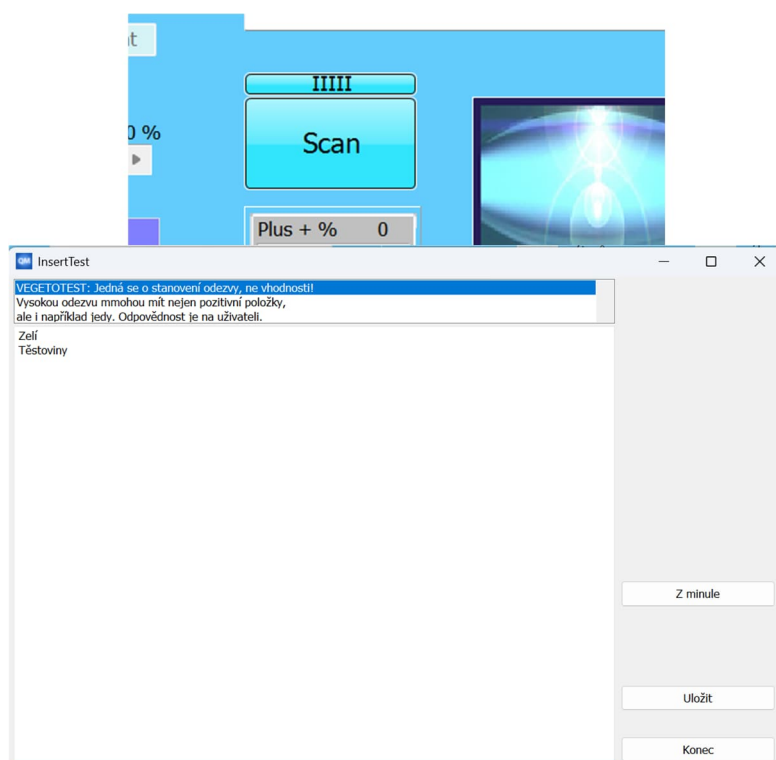

POZOR: Jedná se o stanovení odezvy, ne vhodnosti! Vysokou odezvu mohou přínosné i škodlivé položky. Odpovědnost je na uživateli.

5 Přednastavení

Pomocí tlačítka **Nastavit** se otevře okno, kde lze zadat a uložit globální nastavení.

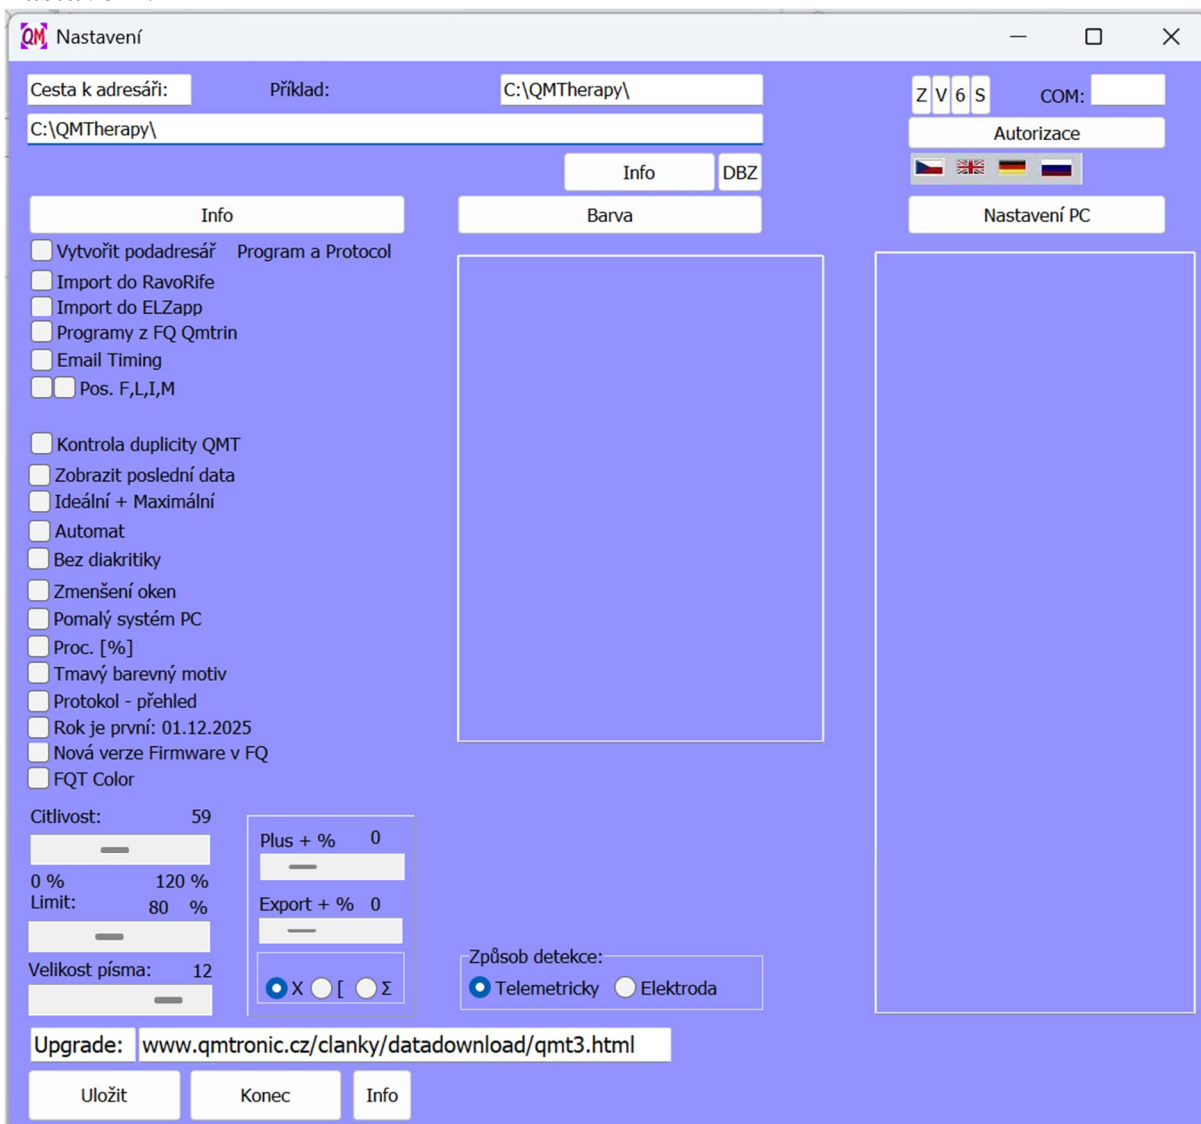

Pokud je nutno přesměrovat ukládání výstupu do požadované složky, vepíše do lišty cesta, kde se mají ukládat programy (dávky) a protokoly zakončená lomítkem "\". Cesta nesmí obsahovat diakritiku (háčky, čárky,..) a musí existovat.

V zadaném adresáři, se automaticky vytvoří podadresář s příjmením a jménem klienta.

Pokud se mají vytvořit i v zadaném adresáři další podadresáře - *Program* a *Protocol*, kam budou ukládány jednotlivé programy (dávky) a protokoly, zaškrtně se okénko.

Vytvořit podadresář Program a Protocol = V případě přesměrování se ve složce se jménem klienta vytvoří složka Program a Protocol.

Import do RavoRife = vytvoří exportní soubor pro Ravo Rife

Import do Elzapp = vytvoří exportní soubor pro Elzapp

Programy z FQ Qmtrin = přidá na konce programu frekvencí i programy doporučené z FQ Qmtrin

Email Timing = v případě zadané e-mailové adresy se při spuštění časování v QM Timing odešle e-mail hlášení.

Pos. F,L,I,M = posice rozlišovacího písmene v souborech s programy (dávkami). Na začátku, v textu, nebo na konci zkratky ze jména.

Kontrola duplicity QMT = (není u všech verzí) pokud je program již v běhu, zobrazí se upozornění při opětovném spuštění.

IserťTest použije z minule = (není u všech verzí) použije v bloku zadávání vlastních přípravků (vegetotest) z minulého zadání.

Zobrazit poslední data = po spuštění programu se načtou data posledního klienta před uzavřením programu.

Ideal + Max. = Vygenerují se navíc i soubory s programy (dávkami) s frekvencemi s ideálním rozsahem a maximálním rozsahem.

Automat = po provedení Scan se spustí automaticky terapie QM Therapy

Bez diakritiky = Názvy souborů klienta se vytváří bez diakritiky. Vhodné v případě cizojazyčných mutací windows.

Zmenšení oken = Vhodné starých počítačů s velmi nízkým rozlišením, zpravidla není nutné využívat.

Pomalý systém PC = Vhodné starých počítačů s nízkou rychlostí, zpravidla není nutné využívat.

Proc. [%] = Zobrazí hodnotu v procentech odpovídající pořadí dané frekvence (POZOR: vliv pouze u frekvencí ne u přípravků)

Tmavý barevný motiv = ztmaví barvu pozadí ve všech oknech. Vhodnější je ponechat světlý motiv, pokud to je možné.

Protokol – přehled = bude se vytvářet a stále doplňovat přehledný protokol k danému klientovi.

Rok je první = pokud v následujícím datu rok první, zaklikne se.

Nová vrze Firmware v FQ = aktivuje se pouze, pokud je v přístroji FQ Qmtrin instalována nová verze, nebo při použití přístroje FQT Gener.

FQT Color = Při spolupráci se FQT Gener, se možnost zaklikne v případě využití nové verze firmware.





V případě, že se získané výstupy využívají v jiném zařízení než je FQ Qmtrin Quantum Harmony např. v zapperu, lze zvolit prodloužení času. Posuvníky **Plus** resp. **Export** lze přednastavit přičítání určitého počtu minut ke všem frekvencím ve všech výstupních souborech resp. jen v souborech pro export.


Citlivost - čím vyšší citlivost, tím více výsledků. Nastavuje se jako výchozí na cca 50 %, tím se získá dostatečné množství výstupu, které lze dát do optimálně dlouhé dávky.


Limit - jedná se o optické oddělení vodorovnou čarou získaných výsledků.


Velikost písma – lze změnit velikost písma. Projeví se až po restartování programu.

Tlačítka  slouží k volbě, případně přednastavení řazení programů ve výstupním souboru.

Tlačítko  je výchozí nastavení.

Tlačítko  (symbol názvu programu – dávky) znamená, že budou všechny soubory výstupních dat odděleny do samostatných programů (dávek) a budou spouštěny odděleně a samostatně.

Tlačítko  (suma) znamená, že všechny soubory výstupních dat budou v jediném program (dávce) a budou spouštěny najednou.





V dalším kroku lze zvolit **způsob detekce** – telemetricky nebo pomocí elektrody.


Pokud se zvolí způsob pomocí elektrody, je nutno držet elektrodu po celou dobu terapie v kterékoliv ruce.



Tlačítko s vlajčkami slouží k výběru jazykové mutace.

Tlačítkem  **Autorizace** se provede autorizace nového programu. Autorizuje se pouze jedenkrát. Při autorizaci se otevře nové okno, kde se zadají základní údaje vlastníka a Heslem licence je číslo uvedené na spodní straně USB jednotky, která je dodána s programem.

Tlačítkem **Res** , které není zobrazeno vždy, se resetuje celý systém. Je nutno zadat však aktivační kód, který lze získat u dodavatele.

 Do okénka **COM** se zadá číslo portu, ke kterému je přiřazen přístroj FQT Gener. Jinak je prázdné.

V prostřední a pravé části okna nastavení jsou přípravky a doplňky.

Zaškrtnutím příslušného okénka vybrat požadované přípravky a doplňky. Přednastavení je nutno zadat a uložit ještě před započítím dalších kroků.

***POZOR:** přípravky, které se nevyužijí, se nezaškrťávají. Před použitím přípravků je nutno se nejprve proškolit v jejich užití! Školení v užití jednotlivých přípravků není součástí dokumentace QM Therapy.*

DŮLEŽITÉ:

Nejdůležitějším a stěžejním výstupem jsou frekvence, přípravky jsou pouze podpůrné. Označte, prosím, pouze ty přípravky, které znáte a opravdu používáte. Přípravky, které nepoužíváte, prosím, neoznačujte, QM Therapy by je brala v úvahu a docházelo by k falešným odezvám v neprospěch ostatních složek.

ZÍSKANÉ FREKVENCE JE VHODNÉ APLIKOVAT OPAKOVANĚ, ZVLÁŠTĚ PŘI AKUTNÍM ZATÍŽENÍ

Získané frekvence nejsou frekvencemi patogenů! Především se je o frekvence, které mají za cíl opravit a zharmonizovat falešné tóny v systému, aby došlo k jeho sladění. Frekvencím patogenů zpravidla předchází frekvence, které připraví systém na řešení.

Zátěže:


Soubor zátěží poskytuje přehled o následujících oblastech:

Disharm System	hrubá disharmonie na úrovni orgánů, lymfy
Disharm Sensitiv	základní disharmonie hormonů, chemie, nervů
Disharm Aura	nejjemnější disharmonie, čakery a energie
Bakterie Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznámá nemoc)
Bakterie Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Bakterie Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Vir Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznámá nemoc)
Vir Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Vir Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Mykóza Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznámá nemoc)
Mykóza Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Mykóza Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Kvasinka Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznámá nemoc)
Kvasinka Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Kvasinka Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Parazit Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznámá nemoc)
Parazit Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Parazit Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Emoce základní	pudové živočišné emoce nezvládnuté, stres


Emoce nadstavba	společenské, vztahové emoce nezvládnuté, stres
Emoce umělé	převzaté, indukované, stres
Vina karmicky	zděděné karmou, přenosem DNA
Vina historicky	naučený postoj vývojem
Vina aktuální	aktuální reakce na okamžitou situaci
Smog elektro	elektro smog, vč. wifi, telefonů, televizního vysílání
Smog geo, rtg	geoanomální záření, vesmírné, ionizující záření
Smog očkov	po očkování, cizí DNA,
Energie - potíže	úroveň, ochota nebo dispozice k napojení na vesmírnou energii
Mysl- potíže	stav mysli a myšlenek. Nízké číslo značí uvolněnou mysl, naději. Vysoké číslo znamená těžké svázanou mysl až beznaděj
Aura- potíže	celkový stav aury a jejích struktur
Conect- potíže	schopnost, ochota, dispozice, nebo úroveň napojení na tvořivou energii universa
Prana- potíže	schopnost, ochota nebo dispozice čerpat pranu

6 QM Scan

Po zadání nacionále klienta se klikne na tlačítko **Scan**. Spustí se detekce (někdo říká měření) a analýza, na jejímž závěru je proveden Scan.



Získané kmitočty lze zobrazit a upravovat pro další použití pomocí tlačítka **Frekvence**. V případě vybraného detailu se zobrazí i kmitočty v daném detailu.

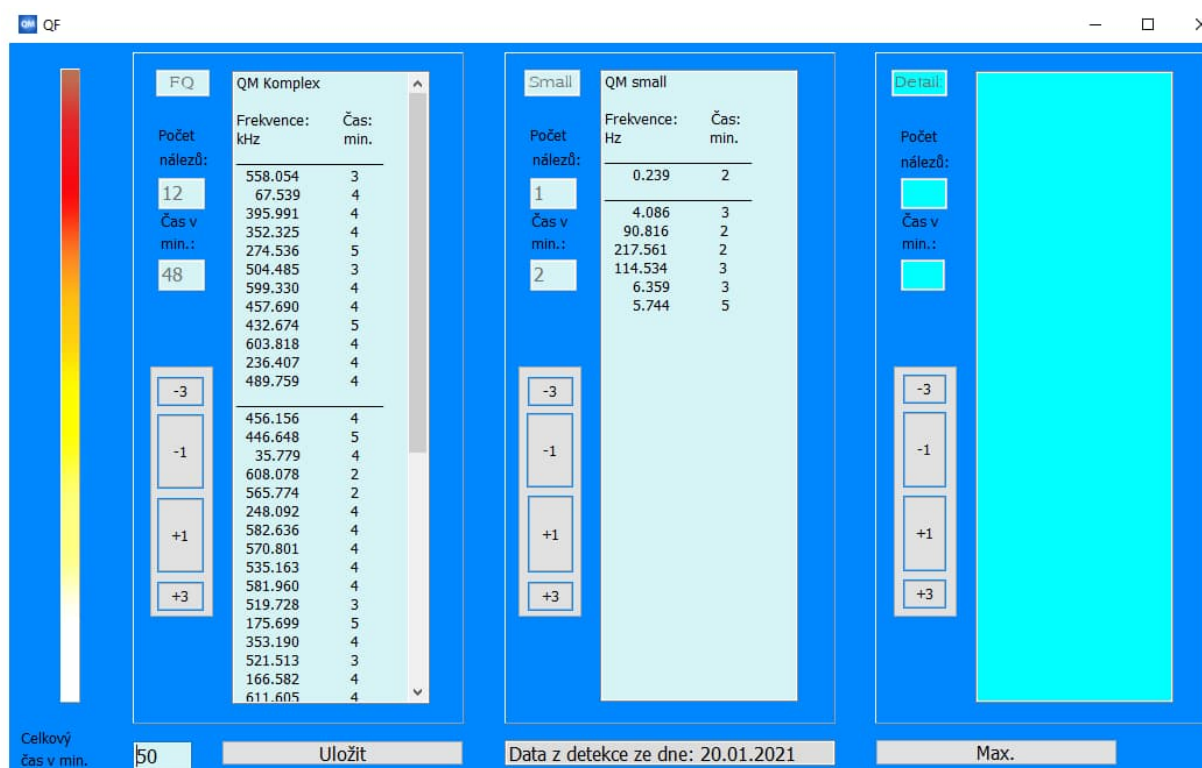


Ve sloupcích nad čarou jsou uvedeny získané kmitočty. Doplnkové kmitočty jsou uvedeny pod čarou. Čáru lze posunovat nahoru nebo dolů tlačítky **-3, -1, +1, +3** a tím rozšiřovat nebo zužovat kmitočtovou sestavu.

Tlačítkem **MAX.** se označí všechny frekvence.

Pořadí kmitočtů nelze měnit, což je důležité, protože na pořadí frekvencí záleží a QM Therapy jejich pořadí velice citlivě zvolil a navrhl.

Kliknutím na tlačítko **Přenos** se přenesou kmitočty nad čarou pro další použití.


Zvolené kmitočty se zobrazí v následující tabulce v hlavním okně.

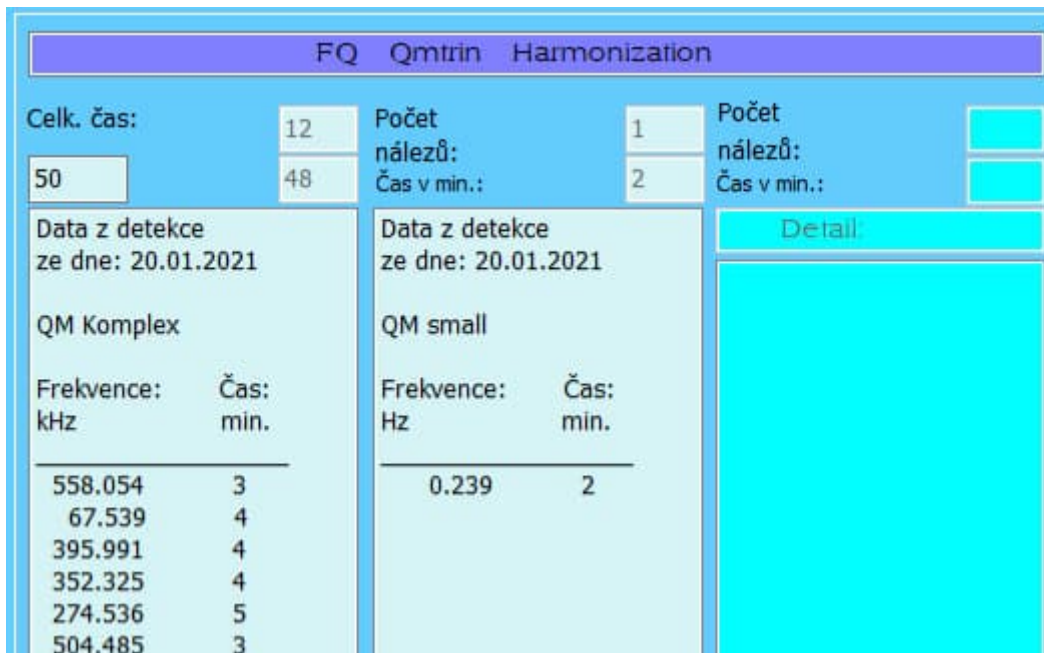

Frekvence: kHz	Čas: min.
558.054	3
67.539	4
395.991	4
352.325	4
274.536	5
504.485	3

Frekvence: Hz	Čas: min.
0.239	2

V horní části je vždy uveden údaj o množství nálezů a suma navržené doby. Je zobrazen i celkový čas, které soubor navržených frekvencí zabere.

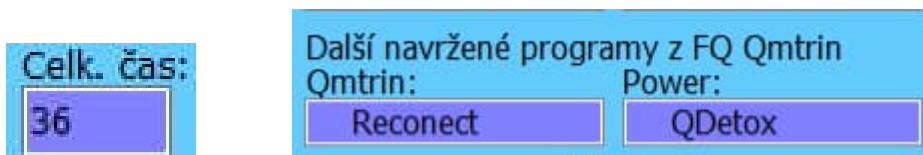

Celk. čas: 36


Další navržené programy z FQ Qmtrin

Power: QDetox

Dále se zobrazí doporučené programy harmonizační z balíčku **Qmtrin** a **Power**, které mají pro celkovou postup **stejnou váhu, jako navržené kmitočty**.

POZOR: Program z balíčku Qmtrin je dostupný pouze v přístrojích FQ Qmtrin a FQT Gener. **V jiných přístrojích tyto NELZE pouštět.**

Jako poslední jsou zobrazena doporučená **Q-Informatika**. Mají rovněž stejnou váhu, jako navržené kmitočty a programy.

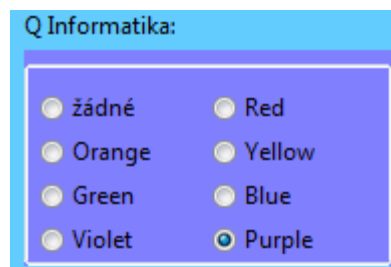

Q Informatika:

☐ žádné
 ☐ Red
 ☐ Yellow
 ☐ Blue
 ☒ Purple

Z principu své činnosti a shodné oblasti působení jako QM Therapy a FQ Qmtrin Quantum Harmony jsou vždy vhodným doplňkem k doporučeným frekvencím a programům.




7 QM Therapy

QM Therapy je kvantová metafysická procedura jako další krok v celém procesu.

Čas běhu terapie lze prodloužit tlačítkem QM T << >>, zpravidla však není nutno.

Případně lze navolit počet opakování tlačítkem QM T /**/**/, zpravidla však není nutno.

Po kliknutí na tlačítko **QM Therapy** se otevře následující okno s informací:

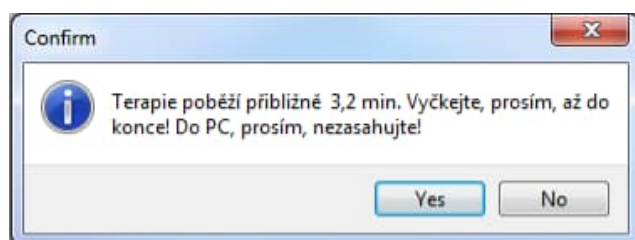

Po kliknutí na tlačítko OK se spustí terapie, která běží v PC. Terapii je nutno **nechat zcela doběhnout až do konce a vyčkat !** Doběhne vždy a na konci se krátce zobrazí hlášení: **Terapie skončena.**


Po dobu běhu terapie je zobrazeno okno:



Modrá stopa na postranních páskách během procedury oběhne jednou dokola.


8 Přehled

Kliknutím na tlačítko **Přehled** se zobrazí nové okno, kde jsou shrnuty získané informace za dříve uskutečněné detekce, vývoj stavu a výhled.

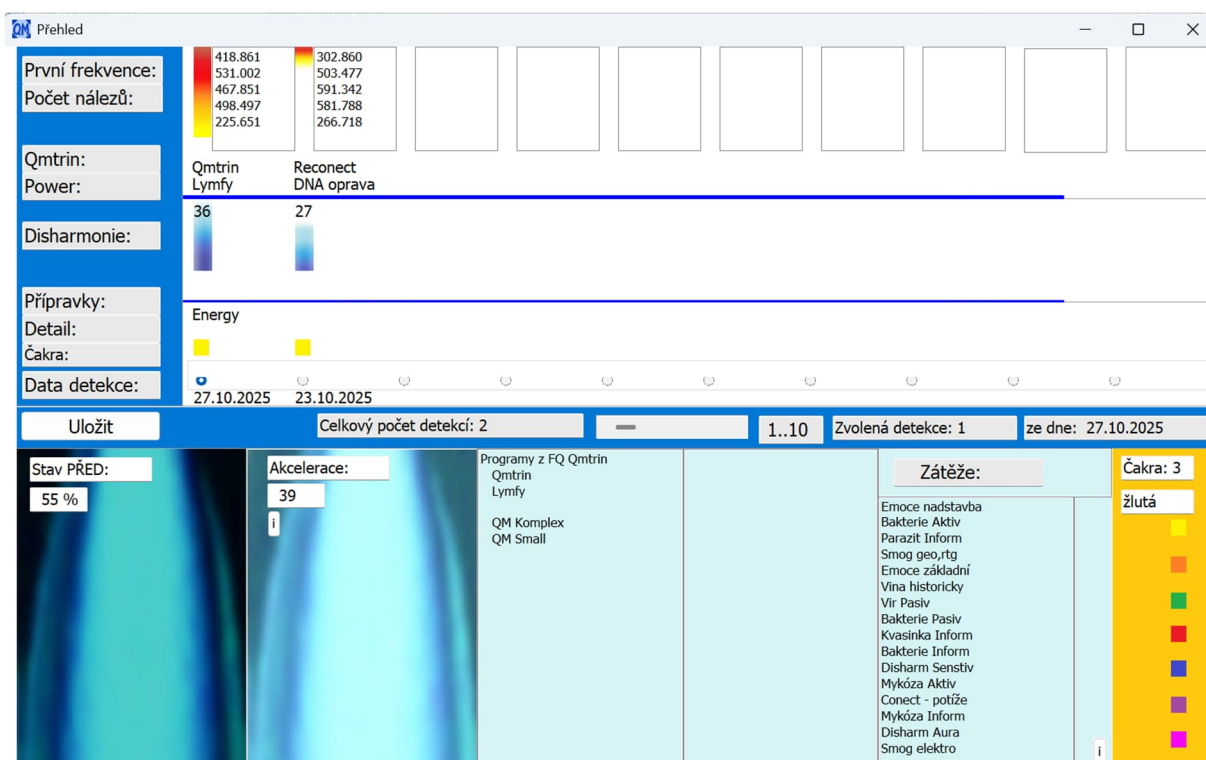

V liště s daty lze vybrat jedno z předchozích detekcí.

Nad lištou je zobrazena nejzatíženější čakra (nemusí se shodovat s doporučenými Q informatiky ani dalšími přípravky).

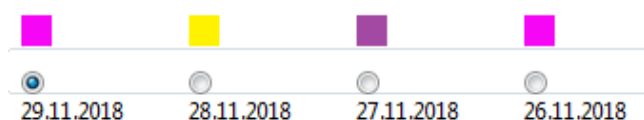

Dále stupeň je uveden relativního rozladění jako disharmonie sloupcem a číslem, které se pohybuje nejčastěji mezi 5 až 50.

Ještě výše jsou doporučené programy z balíčku Qmtrin a z Power.

POZOR: Programy z balíčku Qmtrin lze pouštět pouze v přístrojích FQ Qmtrin Quantum Harmony nebo v FQT Qmtrin. Přestože jsou programy strukturovány obdobně, uvedené přístroje se přepnou do jiného módu a programy se zpracovávají zcela odlišným způsobem!

Na horním okraji je uvedeno pro představu několik prvních frekvencí a červeno žlutou barevnou škálou se symbolizuje celkový počet získaných frekvencí.

Ke zvolené detekci se v dolní části zobrazí řada informací. Bližší informace lze získat pomocí tlačítka „i“.

Dále jsou zobrazeny nejvýznamnější zátěže. V patrnost je vhodné brát pouze hodnoty vyšší než 80-90%

Zátěže:	
Emoce základní	89 %
Parazit Pasiv	85 %
Kvasinka Inform	84 %
Emoce umělé	82 %
Disharm System	81 %
Kvasinka Aktiv	75 %
Kvasinka Pasiv	74 %

Akcelerace - Schopnost a ochota systém realizovat a dosáhnout změnu (nápravu) je symbolizována prosvětlením obrazu uprostřed a číselnou hodnotou. Jedná se o extrapolovaný výsledek s ohledem na provedení všech kroků terapie, tj. QM Therapy, Scan - frekvenční terapie získaných kmitočtů, navržených programu z POWER a na závěr z Qmtrin pomocí přístroje FQ Qmtrin Quantum Harmony a dále využití doporučených informatik, doplňků apod.



Výsledek je předpokládáný, protože po celou dobu probíhá interakce se všednodenní realitou. To je však věcí celkového přístupu sama k sobě a ke svému životu. **Jedná se tedy o měřítko schopnosti a ochoty a schopnosti řešit.**

Zcela vpravo jsou zobrazeny čakry a jejich sled od nejzatíženější nahoře.



Informace v některých oknech lze doplnit značkou •
Značka se dodává kliknutím na řádek s danou informací. Slouží jako poznámky o realizovaných krocích apod.



Při případném zavření tohoto okna tlačítkem **Přenos** se frekvence zvolené detekce přenesou do sloupců frekvencí v hlavním okně, lze je upravovat, nebo i vytvořit dávky a protokoly, jako u nové detekce.

9 Rozšíření


Uživatel může navržené Q-Informatika editovat, dále lze na základě vlastních zkušeností vybrat další vlastní program z FQ Qmtrin Quantum Harmony v záložce **Rozšíření**.

Oba údaje se přenáší do protokolů a neovlivňují další práci programu.



10 Výstupy

Na závěr provedené analýzy a terapie lze shromážděná data připravit pro další použití.




Pomocí tlačítka **Uložit** se provede export a příprava programu pro použití přímo v FQ Qmtrin Quantum Harmony a pokud bylo předvoleno současně pro import do jiných programů apod.


Export se provádí explicitně do složky C:\QMTherapy\Program\, pokud nebyla v **Nastavení** zadána jiná cesta.

Současně se sestaví získaná data do souboru, který lze použít jako protokol z aktuálního dne.

Jsou v něm zaznamenány i navržené programy z balíčků POWER a QMTRIN a navržená informatika a další.


Program a protokol se vytvoří explicitně ve složce zadané v **Nastavení**.

Uskutečněný export je signalizován zaškrtnutým políčkem. Lze provádět opakovaně vždy pro aktuálně zobrazená data. 




Tímto tlačítkem se během exportu přičte zadaná časová konstanta ke všem časovým údajům u frekvencí pouze pro aktuální detekci. Lze přednastavit defaultně v **Nastavení**.

11 Časování QM Therapie (není u všech variant)

Pomocí tlačítka  se otevře nové okno, kde lze spustit časování.

Časování v přednastaveném termínu spustí přednastavenému klientovi QM Therapie a odešle email zprávu, pokud je nastaveno.

Po celou je nutno však mít PC spuštěn a nesmí dojít k jeho automatickému vypnutí.

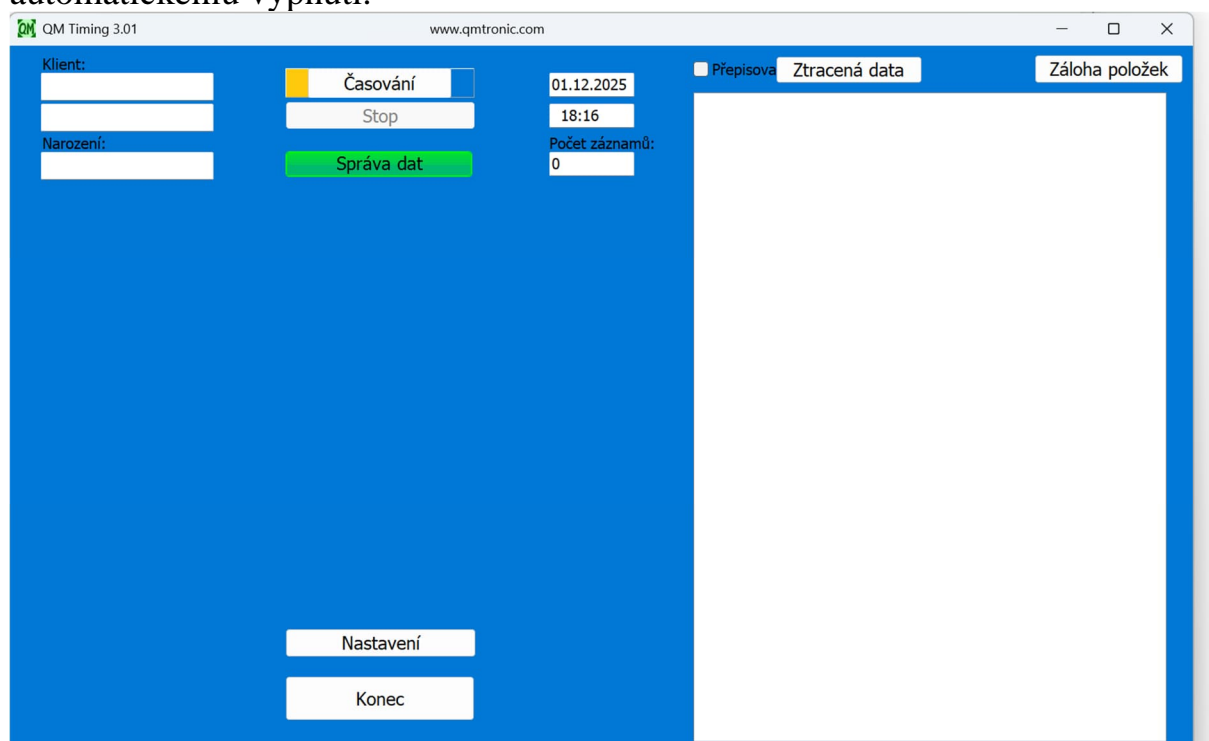


Časování je samostatná procedura a je aktivní i v případě ukončení práce a zavření okna software QM Therapy.



Pokud jsou přednastaveny záznamy s požadavky, lze časování spustit tlačítkem **Časování**.

Ukazatel u tlačítka **Časování** bliká a v přednastaveném čase se spustí QM Therapie, které je obdobná k QM terapii spuštěné v programu.


Spuštěný běh QM Therapie je signalizován následujícím oknem:

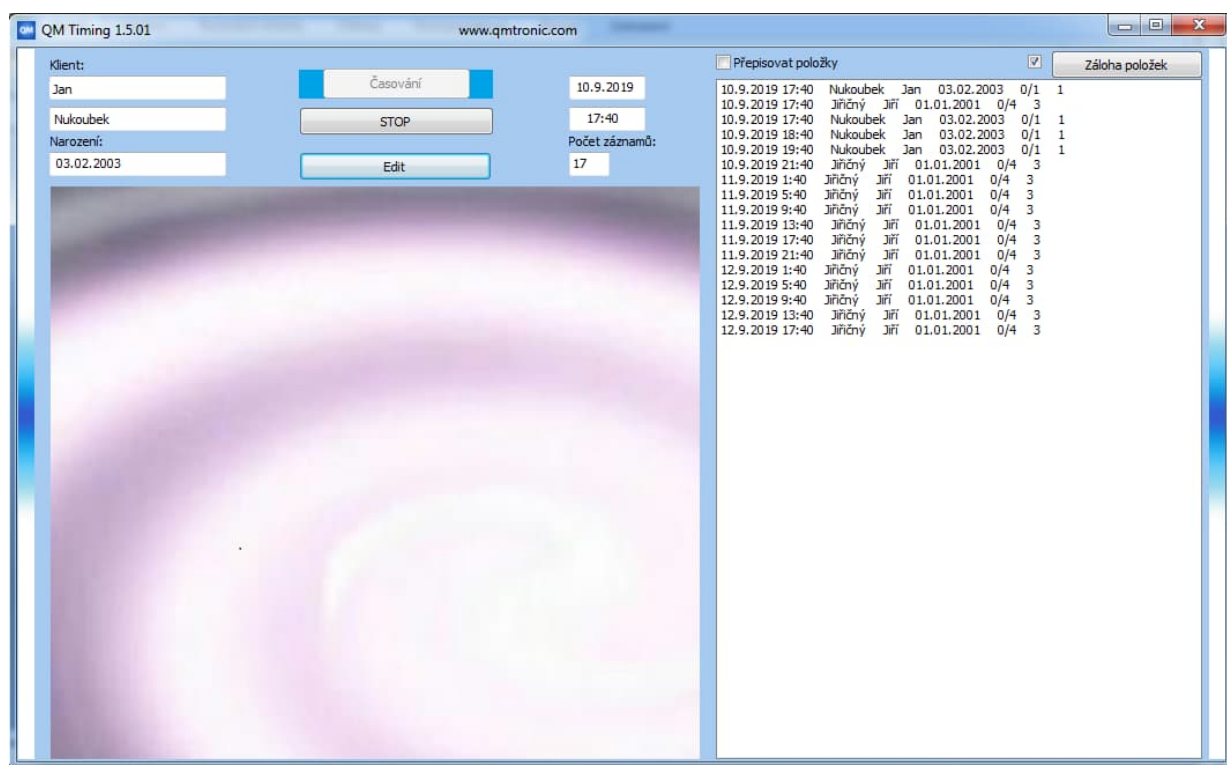


Záznamy o realizovaných terapiích se mohou ukládat v případě označení zátržítkem do souboru. Tento soubor se otevře pomocí tlačítka

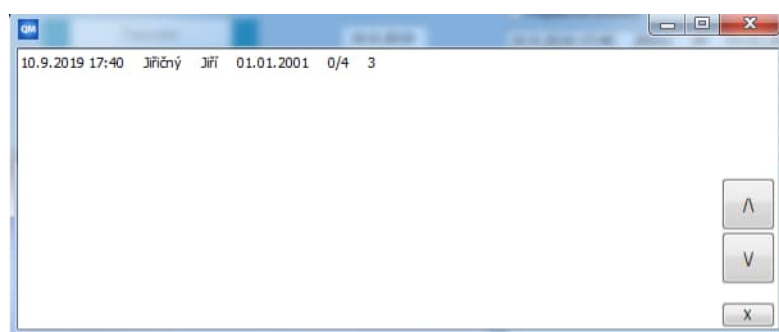

Ztracená data v případě vypnutého počítače se ukládají do souboru a zobrazí se pomocí tlačítka



Pomocí tlačítka **Správa dat** lze provádět nastavení časování.

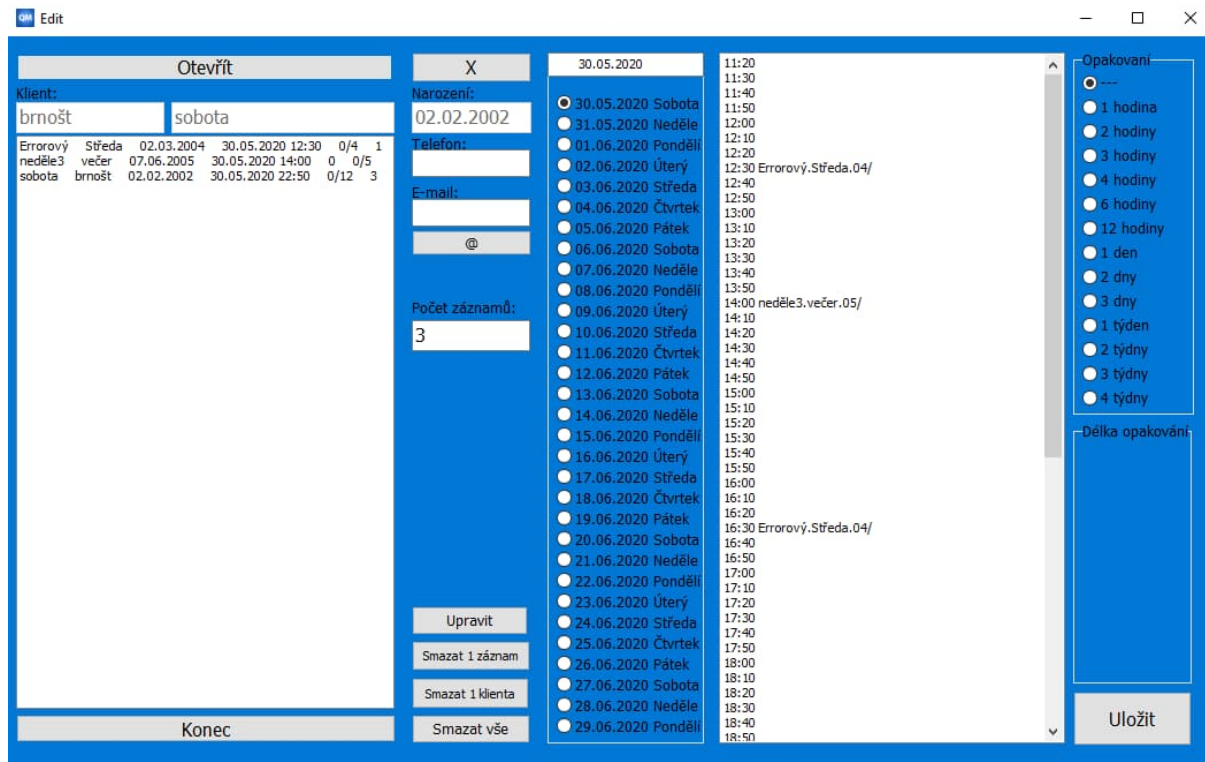

The screenshot shows a software window titled "Edit" with a blue border. It contains several sections:

- Otevřít** (Open): A button to open a patient record.
- Klient:** A section for patient information, including a table with columns for date, time, and duration. The table shows data for "brnošt" and "sobota".
- Narození:** A section for birth information, including a date field set to "02.02.2002".
- Telefon:** A text field for the patient's phone number.
- E-mail:** A text field for the patient's email address, with a "@" symbol button.
- Počet záznamů:** A section for the number of records, with a value of "3" displayed.
- Upravit** (Edit): A button to edit the patient record.
- Smazat 1 záznam** (Delete 1 record): A button to delete a single record.
- Smazat 1 klienta** (Delete 1 client): A button to delete a single client.
- Smazat vše** (Delete all): A button to delete all records.
- Konec** (End): A button to end the session.
- Opakování** (Repetition): A section for setting the repetition of the treatment, with options for hours, days, and weeks.
- Délka opakování** (Duration of repetition): A section for setting the duration of the repetition.
- Uložit** (Save): A button to save the patient record.

Pomocí tlačítka **Otevřít** se otevře dialogové okno pro zvolení klienta. Následně zvolí první den, hodna a případně opakování požadavku na terapii. Po zadání požadovaných dat se záznam uloží pomocí tlačítka **Uložit**.

Takto uložený záznam se zobrazí komplexně v levém okně.

V případě potřeby lze provést jeho editaci tlačítkem **Upravit**, nebo záznam vymazat tlačítkem **Smazat 1 záznam**.

Dále lze smazat všechny záznamy daného klienta tlačítkem **Smazat 1 klienta**, nebo smazat vše tlačítkem **Smazat vše**.

Pokud je počítač připojen k internetu a pokud je zadána e-mailová adresa, dojde k odeslání e-mail upozornění v okamžik startu přednastavené terapie.

Adresu lze vyzkoušet tlačítkem se symbolem @.


12 QM Scan

- Komplexní frekvenční analýza. Princip a postup detekce se však liší zásadním způsobem od dosud používaných metod. Shoda je v tom, že výstupem jsou konkrétní frekvence.
- QM Scan je schopen rozklíčovat strukturální vazby, souvislosti a vztahy.
- Je schopen zaznamenat odezvy živých a neživých mikroorganismů, organických a anorganických patogenů i zbylé patogenní informace a mnoho dalšího zejména „falešné tóny“ vzniklé rozdílem jiných tónů.
- **Získané frekvence nejsou frekvencemi patogenů! Především se je o frekvence, které mají za cíl opravit a zharmonizovat falešné tóny v systému, aby došlo k jeho sladění. Frekvencím patogenů zpravidla předchází frekvence, které připraví systém na řešení.**
- **QM Scan probíhá na dálku bezkontaktně.**
- Komplexní frekvenční analýza probíhá vždy v celém kmitočtovém spektru, čímž je zajištěn celostní přístup a především správné pořadí použití kmitočtových odezev.
- Výstupy jsou konkrétní frekvence.
- Vlastní skenování Scan probíhá zlomek sekundy.
Stejně jako dirigent je schopen ihned při prvních tónech symfonie rozpoznat třeba i jediný falešný tón kteréhokoliv nástroje nebo hudebníka, i kdyby byl orchestr sebevětším tělesem, dovede Scan již ve zlomcích sekundy rozpoznat falešné a neharmonické tóny, ať leží v kterékoliv části frekvenčního spektra a ať mají jakoukoliv podstatu a příčinu. Během detekce dělá každý hudebník hypotetického orchestru to, co je pro něho všední a běžné, tím je eliminován stres a zkreslení, které jinak nastává. Seběmenší nesoulad a disharmonie je natolik vyčnívající z harmonického souladu, že ji QM Scan nepřehlédne.
- Zjištěný falešný a neharmonický tón nebo tóny jsou analyzovány. Na základě výsledků a jejich zpracování je připravena a následně generována frekvence, která má za cíl sladit falešné a disharmonické tóny. Konkrétní kroky a frekvence k řešení se liší případ od případu a vždy zohledňují strukturální vazby, souvislosti, vztahy, čakry, meridiány... Může to být například frekvence konkrétního patogenu, nebo frekvence upravující a posilující činnosti některého orgánu, nebo frekvence na sladění jednotlivých okruhů nebo složek.

Ikonky „i“ slouží k zobrazení více informací o dané skupině.

Uvedené přípravky jsou jen formou doporučení. Dávkování a kombinace je vždy věcí terapeuta. Je nutno, aby byl terapeut v aplikaci daných přípravků proškolen.

Nastavení Vitarego

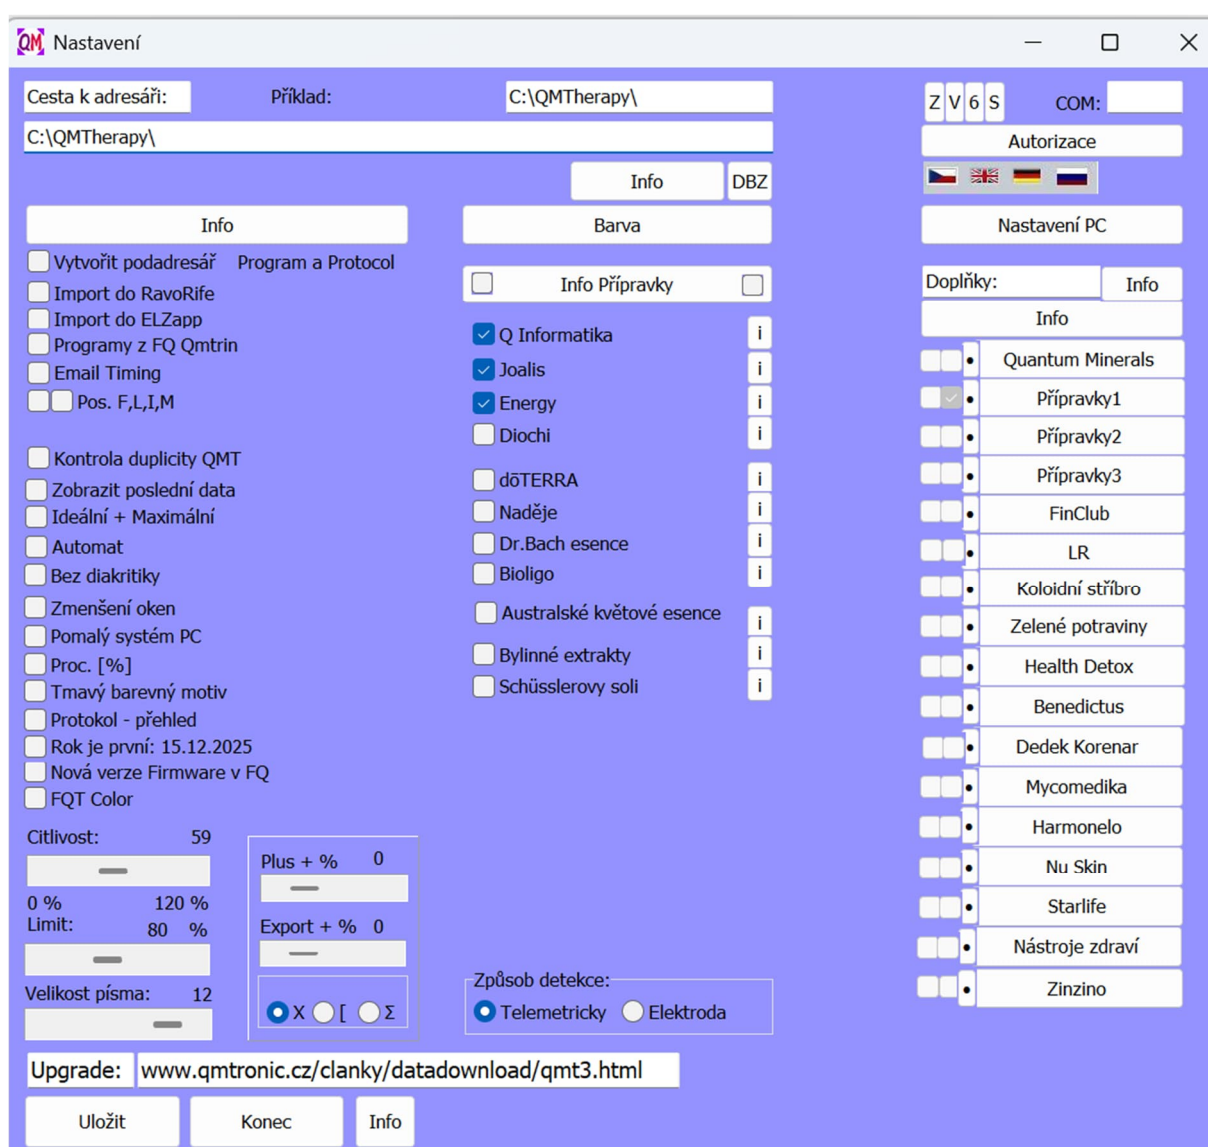

Nastavení

Cesta k adresáři: Příklad: C:\QMTtherapy\

C:\QMTtherapy\

Info

☐ Vytvořit podadresář Program a Protocol

☐ Import do RavoRife

☐ Import do ELZapp

☐ Programy z FQ Qmtrin

☐ Email Timing

☐ Pos. F,L,I,M

☐ Kontrola duplicity QMT

☐ Zobrazit poslední data

☐ Ideální + Maximální

☐ Automat

☐ Bez diakritiky

☐ Zmenšení oken

☐ Pomalý systém PC

☐ Proc. [%]

☐ Tmavý barevný motiv

☐ Protokol - přehled

☐ Rok je první: 15.12.2025

☐ Nová verze Firmware v FQ

☐ FQT Color

Citlivost: 59

0 % 120 %

Limit: 80 %

Velikost písma: 12

Plus + % 0

Export + % 0

☒ X ☐ I ☐ Σ

Barva

☐ Info Přípravky ☐

☒ Q Informatika

☒ Joalis

☒ Energy

☐ Diochi

☐ dōTERRA

☐ Naděje

☐ Dr.Bach esence

☐ Bioligo

☐ Australské květové esence

☐ Bylinné extrakty

☐ Schüsslerovy soli

Z V 6 S **COM:**

Autorizace

☐ ☐ ☐ ☐

Nastavení PC

Doplňky:

Info

☐ Quantum Minerals

☒ Přípravky1

☐ Přípravky2

☐ Přípravky3

☐ FinClub

☐ LR

☐ Koloidní stříbro

☐ Zelené potraviny

☐ Health Detox

☐ Benedictus

☐ Dedek Korenar

☐ Mycomedika

☐ Harmonelo

☐ Nu Skin


☐ Starlife

☐ Nástroje zdraví

☐ Zinzino

Upgrade: www.qmtronic.cz/clanky/datadownload/qmt3.html

Přípravky:

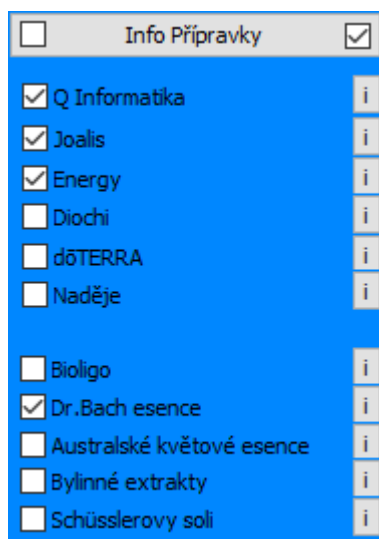

Vlevo zátržítka: přednastavení zobrazení
dvousloupcové výstupy
Vpravo zátržítka: nezobrazuje názvy výrobců


Info Přípravky – zobrazí informace k zadání
přípravků.

Ikonky „i“ slouží pro zobrazení obsahu
přípravků v jednotlivých záložkách.


Doplňky:

Doplňky další preparáty - jsou seskupeny do několika následujících
tlačítek.

Kliknutím na „i“ se zobrazí přehled s obsahem jednotlivých skupin je
v nastavení, nebo zde: C:\WooFqDaz9\PicWqmt\PreparatP.pdf




Prázdné čtverečky symbolizují, že ve skupině není
označen žádný preparát.
Jeden zaškrtnutý čtvereček symbolizuje, že ve skupině
je označen alespoň jeden preparát.
Oba zaškrtnuté čtverečky symbolizují, že ve skupině
jsou označeny všechny preparáty.

Kliknutím na tlačítko  se nejprve označí všechny preparáty v dané
skupině a opětovným kliknutím se zruší označení všech preparátů v dané
skupině bez rozklínávání a otevírání okna dané skupiny.


Po kliknutí na tlačítko s názvem skupinu se zobrazí nové okno pro výběr,
nebo lze vybrat všechny položky najednou. Ikonka „i“ v jednotlivých záložkách
slouží pro zobrazení obsahu přípravků.

Ve spodní části každého okna jsou nástroje pro snadnější označení nebo
odznačení všech položek.

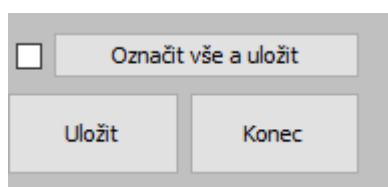

Pokud se vloží do rámečku zátržítko a klikne se na tlačítko ***Označit vše a uložit***, tak se všechny položky onačí a uloží, pokud se zátržítko z rámečku odstraní a klikne se na tlačítko ***Označit vše a uložit***, tak se všechny položky odznačí a uloží.

Příklad:

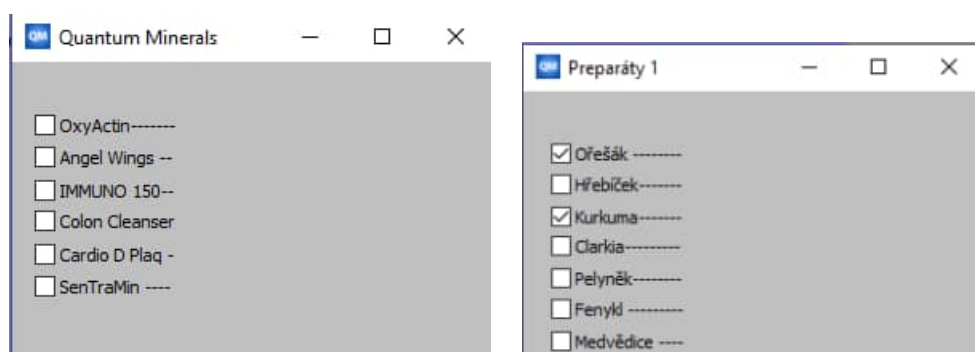

Úplný rozsah je v nastavení v příloze.

14 Podklady

QM Tronic, s.r.o

Mistrovice 62

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO: 28792378

DIČ: CZ28792378

Tel.: +420 469 81 31 24

GSM.: +420 602 62 42 55

qmtronic@qmtronic.cz

www.qmtronic.cz

Záruční list

Na elektronickou funkci přístroje QM Therapy i na vlastní software se vztahuje záruka 24 měsíců od dne předání. Záruční lhůta se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, opotřebením provozem, mechanická poškození, reinstalaci operačního systému, nebo jiné změny provedené v PC. Otevřením přístroje dochází ke ztrátě záruky.

Datum prodeje:

Podpis prodejce: